


SCHWINGGESCHWINDIGKEIT

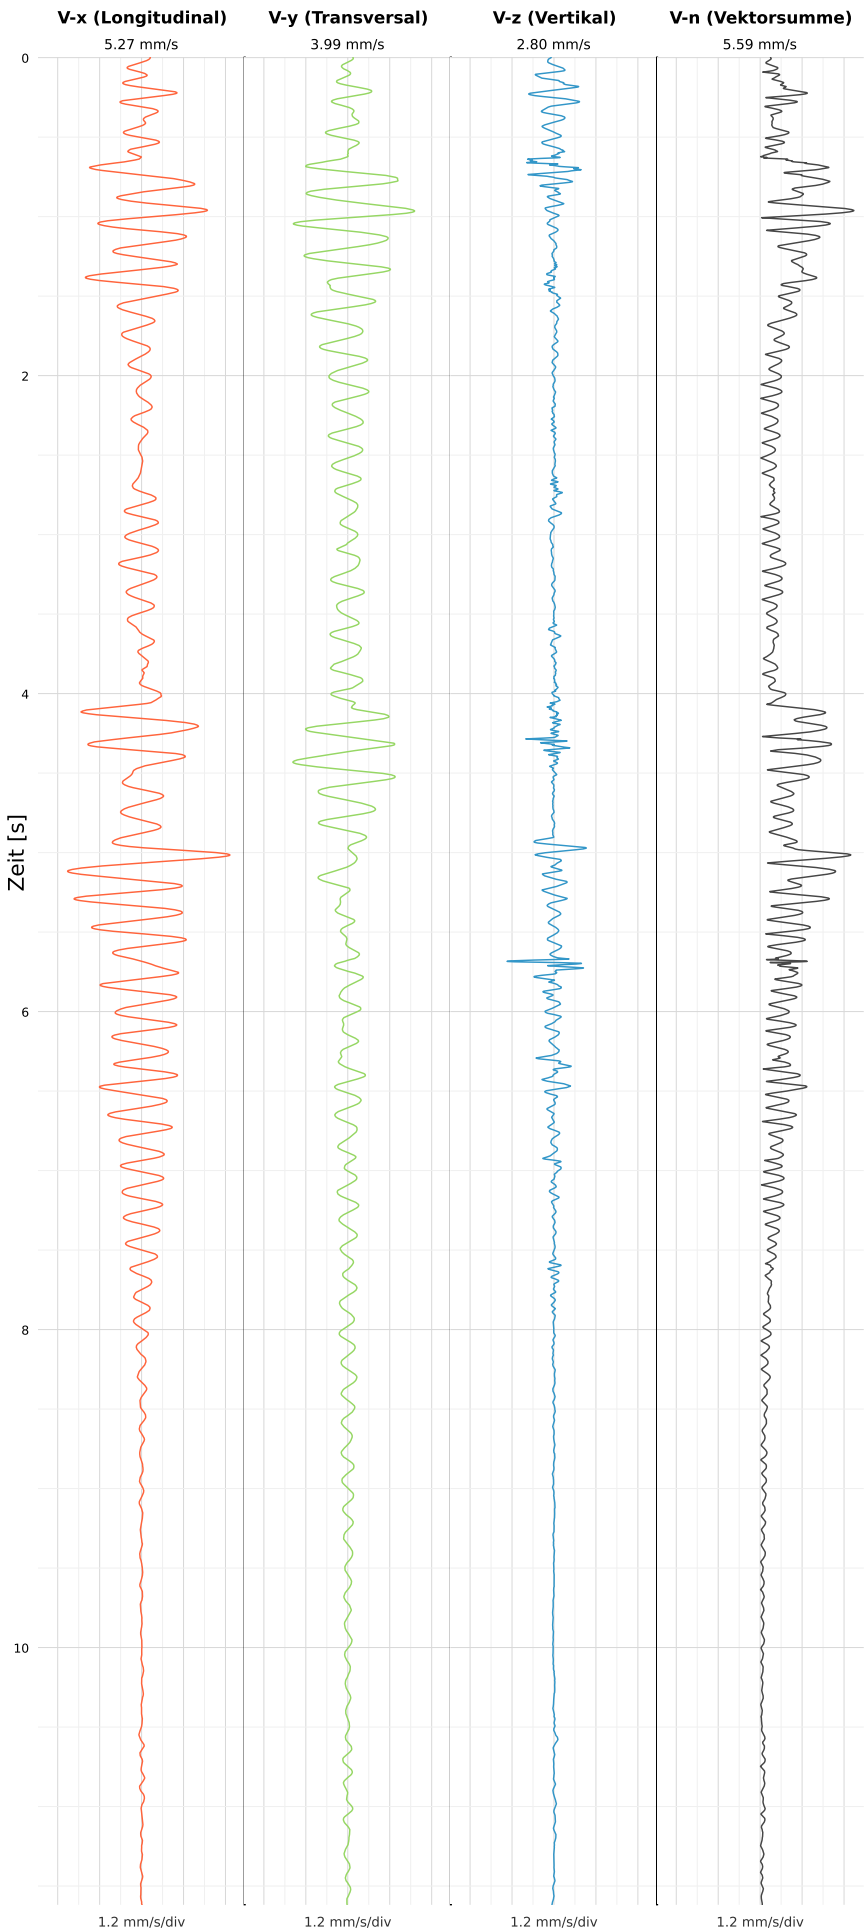


DATEI: 2434-05062026-184702_raw.csv

Aufzeichnungsdauer: 11.62 s | Abtastrate: 1000 Hz

Datum:	05.06.2026	
Zeit:	18:47:02	
Event-ID:	2434-05062026-184702	
Kalibrier Datum:	10.07.2025	
Spitzwerte		
V-x (Longitudinal)	V-y (Transversal)	V-z (Vertikal)
5.27 mm/s	3.99 mm/s	2.80 mm/s
5.9 Hz	5.3 Hz	9.6 Hz
105.36% von Limit	79.73% von Limit	55.96% von Limit
V-n (Vektorsumme): 5.59 mm/s		

SPEKTRALANALYSE - KOMPONENTEN FFT

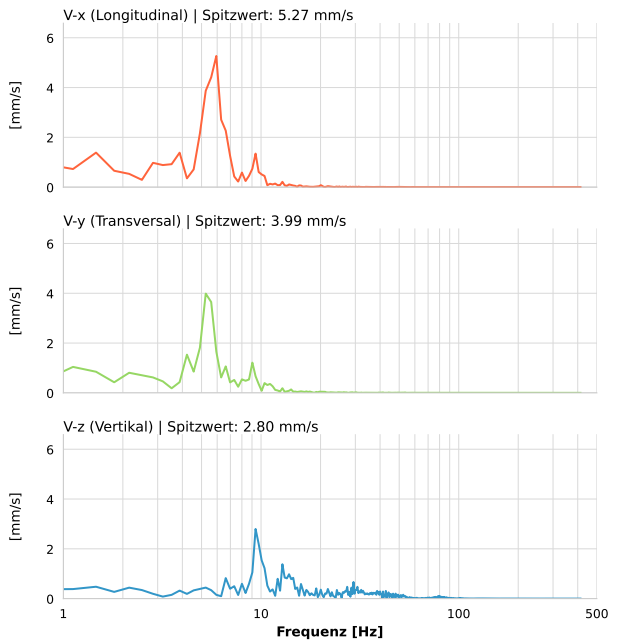

Kanal	Spitzwert	Spektrum 25%	Spektrum 50%	Spektrum 75%
X	5.27 mm/s	4.9 Hz	5.6 Hz	7.0 Hz
Y	3.99 mm/s	4.2 Hz	5.6 Hz	8.4 Hz
Z	2.80 mm/s	9.7 Hz	15.6 Hz	34.5 Hz

SPEKTRALANALYSE - FFT (DIN 4150-3)

